


Használati utasítás BELLAVITA kádlift

Áttekintés

A kádlift segítséget nyújt minden napi hygiénához. Azok számára fejlesztették ki, azok részben, vagy egészben akadályoztatott fizikaiag fűrdesen. A termék célja, hogy segítséget nyújtva a használójának szabadságot és intimitást adjon.

A kádlift fel és le mozgatja a beteget a fürdőkádban, valamint kényelmes hajradási lehetősít. Akkor javasolt, ha a kí- és bezállás, valamint a kádba való belülés és kádból felállás nehézséget jelent.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS –
a HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMSEN OLVASSA
EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

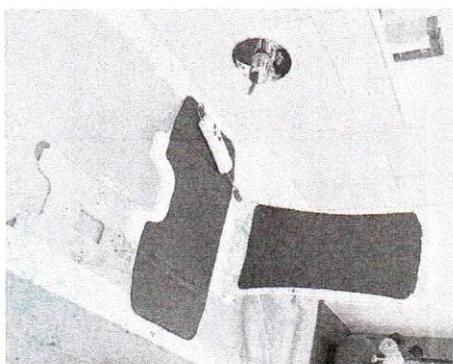


Fontos információk:

- Soha ne használja a kádliftet a kádha töltén be- és kinyájtása sorédeszközöként. Ne használja a liftet általánoként. Emelőszércskezékként, tányaszékként és hasonló funkciókban a lakásban. A liftet kizárolag a kádban történő használatra fejlesztették ki.
- Az állatakat tártsa távol a készüléktől.
- Soha ne invítsa önmaga a készüléket meghibásodás esetén, hanem keresse fel legközelebbi partnert.
- Csak akkor emelje, vagy süllyesse a liftet, ha a háttámla függőleges pozícióba állította és biztosította. Hőforrás közelébe ne állítsa a készüléket!
- Szállítás előtt győződjön meg, hogy a távirányítót eltávolította-e!
- Amennyiben hidegen törtenik a szállítása, akkor használhat előtől várja meg, amíg a készülék teljesen átmelegszik szophőmörséktre.
- Amennyiben fürdőbolhajt, vagy –söt használ körfűtekintőn az ajánlott mennyiséget használja csak a vízbe, mert külfönböző készülékek alkatrészéinek megeszűréséhez vezethet.
- Ecsitasvas tisztítószert soha ne használjon a lift tisztításához.

Az akkumulátorral és a távirányítóval kapcsolatos információk:

- a távirányítói kizárolag a lift működésére használja
 - a liftet csak az eredeti távirányítóval használja
 - soha ne helyezze a távirányítót sugarázó meleg hőhatás közélebe
 - ne szedje szét a távirányítót, mert a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet
 - csak az eredeti tolltól használja az akkumulátor töltéséhez
 - A tolltól csak a kádon kívül, száraz helyiségen használja.
- NAGYON FONTOS, HOGY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTSE FEL AZ ELSŐ HASZNÁLATI ELŐTT TELJESEN!**
- Amennyiben nem használja a kádliftet hosszú ideig, akkor 3 havonta töltse fel az akkumulátort azért, hogy az élettartalma ne csökkenjen.
- Ne dugjon áramvezető tulajdonsgához eszközöt a jack tubomba.
- A távirányítót húzza ki az aljzatából tisztítás megkezdése előtt.
- Száraz ruhával tisztítsa csak a távirányítót.
- A kádlift erői anyagokhoz készült, de erős ütődésre megsérülhet. Amennyiben erre utaló jelet tapint, vagy láthatommal forduljon a szakkereskedőhöz.

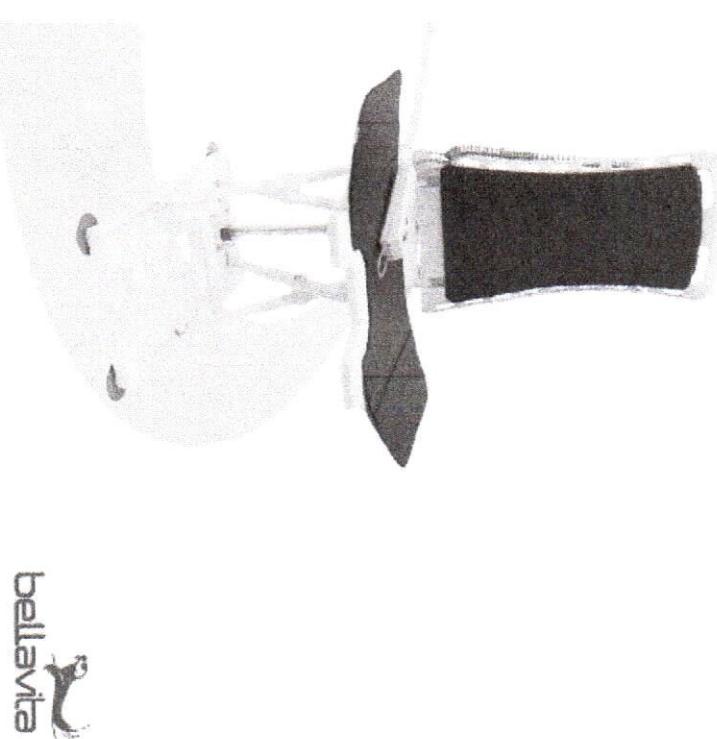

Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel: 88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel: 88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



Fontos biztonsági szabályok:

- Használata megkötése előtt helyezkedjen a lift középső részére, döljön hátra a háttámasznak, lábait kissé egyenesítse ki és egyik kezével kapaszkodjon a kád szélén.
- A lift mozgásáig kapaszkodjon a fűrőkád oldalában.
- Fogyatékos személy esetében a használat esik körül személy jelentélelőíráson.
- Használata előtt végezzon próbamozgatásokat, hogy a lift megfelelően működik-e.
- Ne hagyjon a vízben olyan tárgyat, amely a meghibásodást okozhat a liften (pl. fogkefe ...) beszorulva a készülék tartószerezeitébe.

Elektromos biztonsági nyilatkozat:

A készülék megfelelő a Európai Unió tagállamaira ajánlásíkent tett EMV, IEC 600601-1-2, 89/336/EWG irányelvnek.

Ez azt jelenti, hogy a könyvező elektronágneses jelenségek a készülék használatát igen kis valószínűséggel képesek megzavarni. Ennek ellenére el kell fordulnia, hogy néhány készülék használata (pl. mobil telefon) általani zavart eredményez. Ennek ellenére tartsa távol a lifttől az összes, az elektro is veszélyes elektromos eszközt. Amennyiben ennek ellenére zavart észzel a készülék működésében, kerje tanácsát a szakkereskedőnek.

Kicsomagolás:

Kérjük győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi részeket:

1. lift, háttámla és távirányító
2. ülő lap az oldalszámyakkal
3. akkumulátor töltő
4. használati utasítás
5. az alaplapon elhelyezett 4 db, 75 mm átmérőjű tapadókorong

Bármelyik rész hiányát vagy sértést észleli, jelezze a kereskedőjének.

Először a töltött csomagolja ki, majd az összes többi egységet. Örizze meg a termék dobozát a későbbi esetleges szállítás miatt. Mindenek előtt figyeljen rá, hogy a használat megkezdése előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Ehhez olvassa el az akkumulátor töltésről szóló részt.

Kádba való behelyezés:

Helyezze a 4 tapadó korongot a lift aljára. A korongok filélt ügy fordítva, hogy jól hozzáérjen, ugyanis ezek segítenek a lift könnyű eltávolításához.




Fügynémzetítés:

A szívó korongokat szilárddan jól illeszkedően helyezze el a lift alján, mert csak ekkor fogja tudni kivitelezni a tisztaist és száritást megfelelően. Elszennyezés esetén általános tiszítőszertel lehet a korongokat megtisztítani.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kád tisztta, szennyezés mentes.

Helyezze a kádlistfet az üres kád aljára, majd győződjön meg arról, hogy a tapadó korongok jól illeszkednek a lifthez és a kádhoz egyaránt.

Biztonságosabb tapadás érdekében még kettő, azaz összesen 6 db tapadókorong helyezhető el a lift alján.

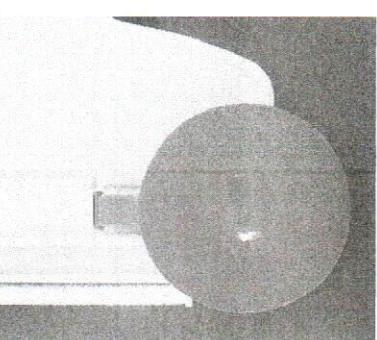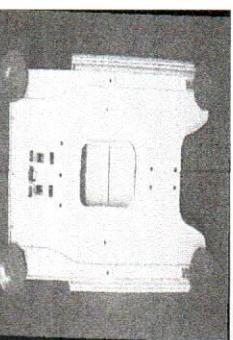
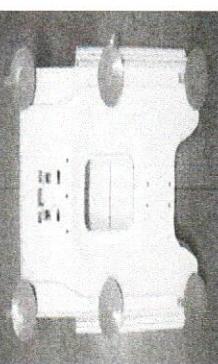


Helyezze el a vezérlő egység-hatlap integrált egységet a hordozó alap egységre.

Fogja meg a háttámlát a fejő részén elhelyezett markolatnál fogva, majd a másik kezével segítve dönthesse hátrafelé az ellenállásig (a kép szerint).


FONTOS: minden vezető csap helyezkedjen megfelelően a kialakított helyén el.

1 - fogantyú



2 - fogadegység

3- csap



Éz követően bozonyosodjon meg, hogy a háttámla boztos pozícióban

Csatlakoztassa a távirányítót a lifthez. Nyomja rá az aljzatot a jackdugóra addig, amíg a jack dugó alján elhelyezett piros jel el nem tűnik. Megjegyzés: Amennyiben a háttámla hatradóméretét zavarja a kád, helyezze előrebb a kadlift alját.

Ez követően ellenőrizze, hogy az emelő ruddazat megfelelően van-e pozicionálva.





Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



GYÓGYSZATI
TUDOMÁNYOS KÖZPONT
www.gyogyaszati.hu


Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu

A takaró felhelyezése és elavolítása:
A takaró felhelyezése és elavolítása könyven kivitelezhető. Helyezze a takarót a háttámlára és bujtassa át a markolat nyílásán. Patíntsza be a rögzítő csapot a furatába. Ugyan így járjon el az üles ere kialakított részein is.
A takaró elavolításához emelje meg a rögzítő gomb körül a szövetet két kézzel. A kádlef használható takaró nélkül is.

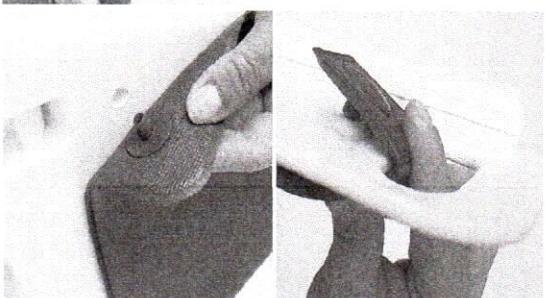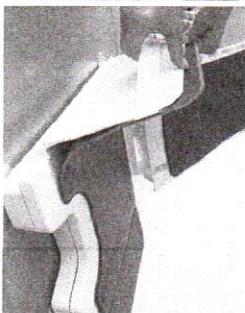

A fejtaró felhelyezése
(opcionálisan vásárolható meg):

Helyezze be a fejtámaszt két rúdiát a hattámasz erek kialakított furataiba. Alítsa be a fejtámaszt a kívánt magasságba.

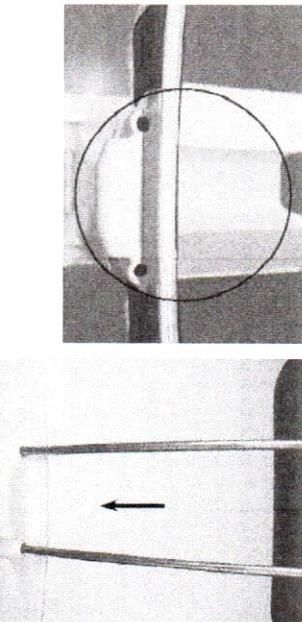

Singősségi gomb:

Bármely esetben, amikor a lift azonműani megállítása szükséges, nyomja meg a poros, súrgósségi gombot. Az újra indításhoz nyomja meg a zöld bekapsoltó gombot.

A kádlef automatikusan kikapsol 30 perc áltás után. Amennyiben Ön szeretné kikapsolni a készüléket, akkor nyomja meg a vörös gombot.

A lift használata a kádban:

1. A használat előre győződjön meg rólá, hogy a távirányító megfelelően van-e csatlkoztatva a készülékhez. A jack dugó vörös gumiujrat nem szabad látni, ha megfelelően van csatlakoztatva. Kapsolja be a zöld bekapsoltó gombot. Ekkor a LED zölden világít.
2. Nyomja meg a felfelé morgató gombot és tartsa lenyomva ameddig a lift teljesen fel nem emelked a legfelső pozícióból és leáll. Ez alatti magasság is kálasztható később, ekkor a kívánt magasságban engedje el az emelő gombot.
3. Hajtsa ki az illsz számyai a kád széléről. Mozgassa a liftet addig a pozícióig, hogy a számyak az ülessel egy magasságban legyenek.
4. Üljen rá a liftre és csúszon az illsz köepére.
5. Engedje le a liftet a súlyvezető dobombal. Amikor a lift elérte a legalsó pozícióját a hattámla kezd el dörni. A hattámla addig dől amíg a gombot nyomva tarja, vagy előre a leghátsó pozíciójáig (50 fok).

FIGYELEM: ha a hattámla elérte a kád hátsó falát, azonnal engedje el a gombot.

6. Fűrdes után nyomja meg az emelő gombot és emelje fel a liftet a kád felső szintjéig.
7. Csúszon ki az ülőről a kád széléről és szálljon ki.



A kádlef kikapsol kb. 30 perccel a bekapsolást követően. Újra indításhoz nyomja meg a piros gombot.

A lift mozgatásakor a kezét helyezze az ötöre, vagy a combjára.

Amennyiben a liftet a kádban hagyja, távolítsa el a távirányítót a lemerülés elkerülése érdekében.

Gombok kiosztása:


1. súlyezői gomb (a lift súlyoz)
2. súrgósségi kikapsoltó gomb (vörös)
3. kontroll LED lámpa
4. emelő gomb (a lift emelkedik)
5. bekapsoltó gomb (zöld)

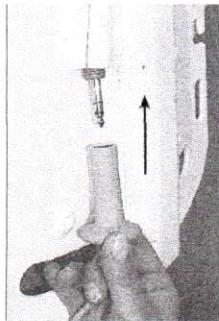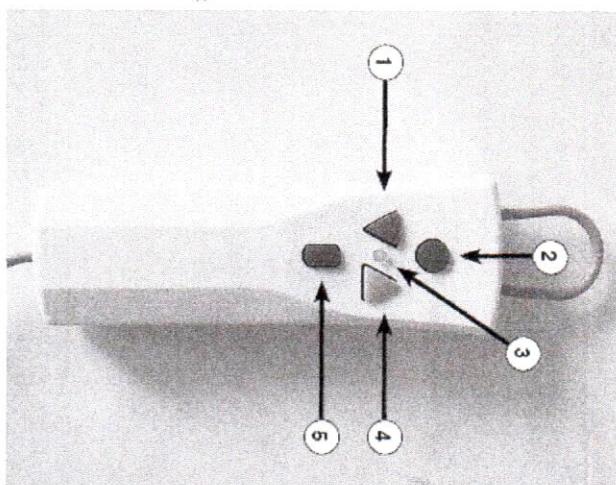


A lift eltávolítása a kádból:

Engedje le a kádliftet a legalább pozíciójába és a háttámláit is döntse a leghatásos pozícióba. Figyeljen rá, hogy a kád hasó fala ne akadályozza a lift mozgását!


1. hajtsa be az iles oldalszárnyait
2. használja a kialakított markolatokat a lift mozgatásához



3. győződjön meg róla, hogy a műanyag rúd teljesen visszahúzódott-e

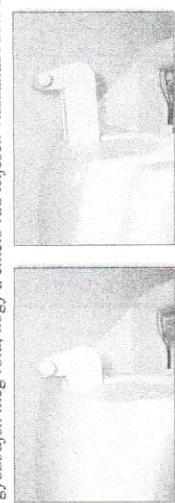

4. Ez követően távolítsa el a háttámla rész az ülőülépről. FIGYELME: a háttámla csak bizonyos pozícióba állítható a törölhetővel. Teljesen lehajta nem távolítható el! Az alsó képen látható pozícióba hozza a háttámlát és ezt követően távolítsa el.

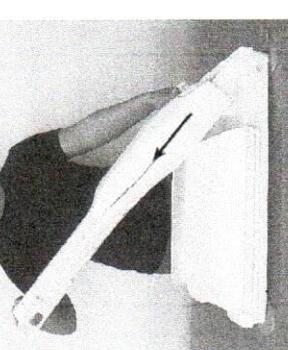

5. A tapadó korongok nyelvét húzza távolítva el az aljzatot a kádból. Ha netán az előző korongok a kádba tapadnak, azt később könnyedén el tudja távolítani.

Kádlift tárolása:

A kádlift karbantartás mentes, nincs szükség külön kenésre, olajozásra.

12 havonta javasolt átnézni a lift alkatrészzeit, tökenti a teherhordó részeket, hogy nem érte-e sérülés. Az átnézés része legyen a teljes funkcionális teszt is. Amennyiben meghibásodást észlel azonnal jelezze a szerviznek, kereskedőjének.

Tisztítás:

A kádlift megfelelő karbantartásához hozzá kell tartozik, hogy fürdést követően tisztítssa meg. Többnyire elégleges a műleg vízzel törékeny lezuhanyozás. Amennyiben erősebb szennyeződést éri a liftet, akkor használjon általános tisztítószeret.

Az ülőstolak karbantartása:

A takaró a sima felülete és az antibakteriális tulajdonsága miatt higiénikus, könnyen tisztítható. A takaró körézzel tisztítható, vagy mosogatáshoz 60 fokon. Olyan mosószer használható, amely nem rendelkezik enzimatiskus tulajdonsággal. Fürdőolaj, vagy színezéket tartalmazó mosószerök, mosakodó szerek a takaró elszíneződéshez vezethetnek. A takaró tisztításának elhanyagolása is elszíneződéshez járhat. A takaró elszíneződése normali használat mellett is előfordulhat, erre a garancia nem teljes ki. A takaró eltávolítása rendkívül egyszerű. A száritást egyszerű kiakaszással végezze.

A kádlift karbantartása:

A. A kádlift karbantartási nem igényel, kenés-olajozási igényű alkatrészre nincs.
12 havonta nézze át a kádlift fő alkatrészét, különös tekintettel a teherhordó alkatrészekre. Ekkor végezze el a kádösszes funkcionális tesztjeit is. Amennyiben olyan hibát észlel, amely érintheti a kádlift működését, akkor annak kijavításig ne használja. A javítást szakmáhelyben, erre kiképzett személyelvégzésre.

Tisztítás:

Használat után minden esetben zuhanyozza le a műleg vízzel a kádliftet azért, hogy a szemnyeződéseket eltávolítsa. A vegyszerek tisztításhoz egyszerű általános tisztítószeren használjon.

Ülestakaró karbantartás: Az ülestakaró erre kifejlesztett nagyon sima felszínű antibakteriális tulajdonságú anyagból készült. Az ülestakaró erre kifejlesztett nagyon sima felszínű és antibakteriális tulajdonságú anyagból készült. Időszakos tisztítás akár kézzel, akár 60 fokos gépi mosással végezhet. A mosáshoz nem enzimatiskus tulajdonságú tisztítószer használható csak. Fürdőolajok, vagy egyéb fürdőszerekhez adott anyagokat a takaró elszíneződését okozhatják. Az elszíneződés normali használat mellett is bekövetkezhet. Ez a funkció játéknem befolyásolja és nem tartozik garanciás körbe.

NE FELEDE:

- a takaró könnyen eltávolítható a tisztításhoz
- ne száritsa a takarót elektromos száritóban
- általános tisztítószer alkalmass a tisztításra

A töltő karbantartása:

A töltő nem igényel karbantartást. A tisztítást oldószer mentes közepes erőségű detergenssel és puha ruhával végezze. Víz ne jusson be a töltő belsőjébe. Újra használat előtt győződjön meg, hogy kiszáradt-e teljesen.



A törölt akkumulátor töltése:

Mindig győződjön meg, hogy az akkumulátor feltöltött-e teljesen használat előtt. Ellenőrizze, hogy a haláztáti feszültség 220V.

1. dugja össze a töltőt és a törárványtúlito megfelelő részét
2. dugja be a konnektorba a töltőt. A törárványtúlito piros lámpája világítani kezd és zöldre változik, ha a töltés megtörtént. A teljes töltési idő kb 4 óra. A töltő automatikusan megszakítja a töltést kb 4 óra elteltevel, azért, hogy a töltőtést megakadályozza.
3. távolítsa el a töltőt a konnektorból
4. válassza szét a töltőt a törárványtóból

FONTTOS:

- amennyiben a kontrol lámpa nem világít a haláztátha való bedugáskor, akkor ellenőrizze, hogy a töltő és a törárványtúlito kapcsolata biztos-e
 - a töltő csak száraz helyiségen használja, fürdőszobában soha sem
- Szállítás:**
1. minden távolítsa el a törárványtúlito szállítás előtt a készülékkről
 2. fixen rögzítse a szállítás alatt a kádliftet
 3. amennyiben hűtőgél közégen törékeni a szállítás, akkor újra használható előtt az akkumulátor engedje felmelegedni szobahőmérsékletre
 4. az ülőrész súlya 5,5 kg., a vezérlő háttámla rész súlya 3,8 kg
 5. a kápen látható módon a kádlift egyben és szétszerelt állapotban is szállítható

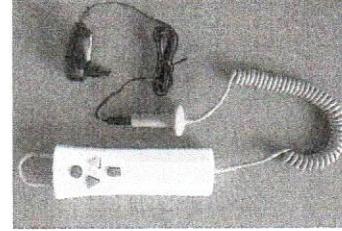

Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu




Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu

Technikai adatok:

Teljes hossz: 830 mm
Teljes szélesség: 700 mm
Üldlap szélesség: 350 mm
Üldlap mélysége: 420 mm
Az üldlap teljes hossza: 570 mm
Üldöföllet minimalis magassága: 60 mm
Üldöföllet maximalis magassága: 480 mm
Üldöföllet hossza: 640 mm
Háttámla szélessége: 320-360 mm
Háttámla dölfészszöge: 10-50 fok
Aljzat szélessége: 310 mm

Aljzat hossza: 560 mm
Maximalis terhelhetőség: 140 kg
Tejes súly: 9,3 kg
Távirányító súlya: 0,4 kg
Üldözögegyes súlya: 3,8 kg
Üldözösi súly: 5,5 kg
Egy ciklus ideje: 50 s
Működési feszültség: 12V
Automatikus kikapcsolás: max 30 min
Teljesítmény: 90W 12V
Működési környezeti hőmérséklet: 10-50 fok
Szállítási környezeti hőmérséklet: -10-+40 fok

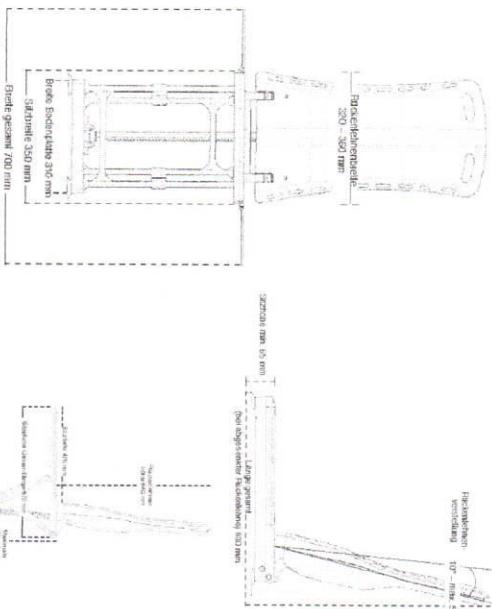**Garancia: 12 hó**

Eladás kelte:

Forgalmazó aláírás, pecsét:

Gyártói címke:

1 Cikkszám |
2 Cikk neve |
3 Gyártó |
4 Sorozat szám |
5 UDI-kód |
6 Max. raktárra |
7 Kövesse az utasításokat használattal! |
8 Övvízi eszköz |
9 Gyártási dátum (év-hónap)



